

Ilustríssimo Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Pirapora - MG

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO 031/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2024

OBJETO: O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de **EQUIPAMENTOS HOSPITALARES para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Pirapora-MG**, nas quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A MHEDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.788.729/0001-32, com sede na Rua Adelino Testi, nº 251 – Bairro Olhos D’Água, Belo Horizonte – MG CEP 30.390-070, por seu representante legal infra-assinado, tempestivamente, vem, com fulcro no inciso I art. 165 alíneas b e c, § 1º e 2º da lei 14.133, à presença de Vossa Excelência, a fim de interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO,

contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que julgou pela **HABILITAÇÃO** da empresa arrematante.

I – DOS FATOS SUBJACENTES

Acudindo ao chamamento dessa Instituição para a Pregão Eletrônico, a recorrente e outras licitantes, dele vieram participar.

II – DO EXPOSTO PELO PARECER TÉCNICO E JULGAMENTO PELA HABILITAÇÃO

HAIYE Modelo HYHJ-KC

Edital solicita: Monitor de vídeo tipo LED ou LCD, imagens a cores, tamanho de no mínimo 3 polegadas; resolução de 640 x 480 (rgb);

Conforme página 4 do manual Anvisa, o videolaringo HAIYE / HYHJ-KC informa que possui uma tela de 3 polegadas, mas em seu manual não existe nenhuma informação da resolução de tela, ficando claro o não atendimento ao requisito de resolução de tela conforme solicitado em edital.

1.1 Faixa de aplicação:

Para o uso de intubação endotraqueal em anestesia e resgate.

1.2 Indicadores de desempenho:

Categoria do equipamento: fonte de alimentação interna.

Equipamento de propriedade: equipamento tipo BF, , operação contínua.

Item	Nome	Indicador Técnico
	Exibição	LCD colorido de 3"

Edital solicita: Ângulo de visão de no mínimo 150°, inclinação mínima de 0 ~110°; rotação mínima de 0 ~250°,

Conforme página 4 do manual Anvisa, o videolaringo HAIYE / HYHJ-KC possui somente ângulo de visão apenas de 70° e não existe nenhuma informação da inclinação e rotação que o equipamento possui, dessa forma, fica claro que o equipamento não atende ao solicitado em edital.

1.1 Faixa de aplicação:

Para o uso de intubação endotraqueal em anestesia e resgate.

1.2 Indicadores de desempenho:

Categoria do equipamento: fonte de alimentação interna.

Equipamento de propriedade: equipamento tipo BF, , operação contínua.

Item	Nome	Indicador Técnico
	Exibição	LCD colorido de 3"
	Ângulo de visão	70°±2°

Edital solicita: Display com possibilidade de intercâmbio com outros dispositivos de intubação, tais como flexíveis.

Conforme página 6 do manual Anvisa, o videolaringo HAIYE / HYHJ-KC não possui disponibilidade de intercâmbio com outros dispositivos por sua tela ser integrada ao corpo do videolaringo, ficando claro que equipamento não atende ao solicitado em edital.

Desenho da estrutura:



Adptador de energia

Hugemed/SHENZHEN HUGEMED TECHNICAL DEVELOPMENT CO. Modelo VL3R

Edital solicita: Ângulo de visão de no mínimo 150°, inclinação mínima de 0 ~110°; rotação mínima de 0 ~250°,

Conforme página 40 do manual Anvisa, o videolaringo HUGEMED modelo VL3R possui ângulo rotacional frontal e traseira $\geq 120^\circ$ Faixa de ângulo rotacional esquerda e direita $\geq 120^\circ$ e não existe nenhuma informação do ângulo de visão e inclinação que o equipamento possui, dessa forma, fica claro que o equipamento não atende ao solicitado em edital.

A.4 Parâmetros Básicos

Parâmetros	Especificações
Ângulo rotacional	Faixa de ângulo rotacional frontal e traseira $\geq 120^\circ$ Faixa de ângulo rotacional esquerda e direita $\geq 120^\circ$

40

Edital solicita: memória interna de no mínimo 8GB com possibilidade de expansão de até 32 GB para armazenagem.

Após análise minuciosa do manual Anvisa do equipamento HUGEMED modelo VL3R, não existe nenhuma informação da capacidade de memória interna do equipamento, dessa forma, fica claro o não atendimento do equipamento no que é solicitado em edital.

Edital solicita: Display com possibilidade de intercâmbio com outros dispositivos de intubação, tais como flexíveis.


Conforme páginas 2 e 9 do manual Anvisa, o videolaringo HUGEMED modelo VL3R não possui disponibilidade de intercâmbio com outros dispositivos por sua tela ser integrada ao corpo do videolaringo, ficando claro que equipamento não atende ao solicitado em edital.

Desempenho, estrutura e composição do produto: Constituído de quatro peças: adaptador de energia, receptor de exibição, alça e conjunto de câmera. O VL3R possui um conjunto de câmera integrado e lentes de videolaringoscópio reutilizáveis que pode

2.2 Aparência Externa do Produto

2.2.1 Vista Lateral

2.2.1.1 VL3R Videolaringoscópio (repetibilidade)

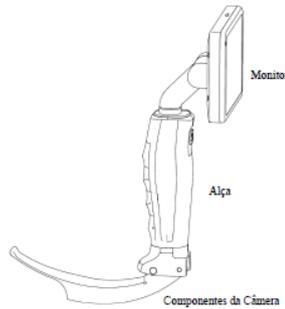

[Imagem 2-1] Vista lateral do VL3R

RTS - MEDCAPTAIN Modelo VS-10

Edital solicita: Ângulo de visão de no mínimo 150°, inclinação mínima de 0 ~110°; rotação mínima de 0 ~250°,

Conforme a informação do manual Anvisa do equipamento MEDCAPTAIN Modelo VS-10, é informado somente que o equipamento possui rotação vertical e horizontal, não informado os graus da rotação e não informa o campo de visão e a inclinação que a tela do equipamento possui, dessa forma, fica claro que o equipamento não atende ao solicitado em edital.

ESPECIFICAÇÃO:



Junta de pressão encaixe	/	Usada para travar a lâmina do laringoscópio.
Eixo de três vias		Usado para conectar o conjunto da tela e o conjunto da manopla e para permitir a rotação vertical e horizontal da tela.
Botão de tirar fotos / gravar vídeo		No estado ligado, você pode pressionar esse botão para tirar uma foto e armazená-la na biblioteca multimídia. Você também pode pressionar e segurar este botão para começar a gravar um vídeo. O vídeo gravado também é armazenado na biblioteca multimídia.
Tampa da Alça		Utilizada para prender a alça.

Edital solicita: Display com possibilidade de intercâmbio com outros dispositivos de intubação, tais como flexíveis.

Conforme a informação do manual Anvisa do equipamento MEDCAPTAIN Modelo VS-10, o equipamento não possui disponibilidade de intercâmbio com outros dispositivos por sua tela ser integrada ao corpo do videolaringo, ficando claro que equipamento não atende ao solicitado em edital.

ESPECIFICAÇÃO:



Edital solicita: Acessórios que acompanham o equipamento: 01 kit de lâminas reutilizáveis autoclaváveis nos tamanhos neonatal, pediátrico, adulto e adulto grande;

Conforme a informação do manual Anvisa do equipamento MEDCAPTAIN Modelo VS-10, o equipamento possui somente lâminas descartáveis, ficando claro o não atendimento do que foi solicitado em edital.

INSTRUÇÕES DE USO:

O videolaringoscópio VS-10S / VS-10H deve ser usado em combinação com a lâmina descartável do laringoscópio fabricada pela MEDCAPTAIN LIFE SCIENCE CO., LTDA para facilitar a intubação suave.

As Lâminas são fornecidas separadamente estéreis e de utilização única.

III – DO PEDIDO

De sorte que, com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, requer-se o provimento do presente recurso, com efeito para que seja anulada a decisão em apreço, na parte atacada neste, declarando-se a empresa **MHÉDICA SERVICE**, habilitada com base no que foi demonstrado de forma clara e objetiva, para prosseguir no pleito.

Em que preze o zelo e o empenho desta digníssima Comissão de Licitação em guardar o caráter isonômico do procedimento, respeitando os Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade Administrativa, da Economicidade, da Razoabilidade e da Supremacia do Poder Público, pede-se que a decisão proferida no **Pregão eletrônico** seja revista.

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este subir, devidamente informados, à autoridade superior, em conformidade com o no inciso I art. 165 alíneas b e c, § 1º e 2º da lei 14.133.

Nestes Termos

P. Deferimento

Belo Horizonte, 30 de outubro de 2024.

**MHEDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS HOSPITALARES LTDA – EPP
CNPJ 24.788.729/0001-32
Mirna Maria Tomelin Sorbello
ID. MG16.600.282 / CPF: 354.440.619-53
Diretora**